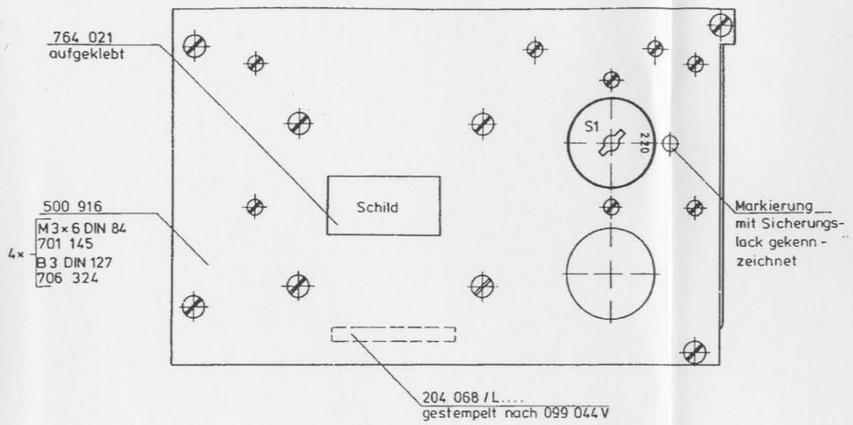

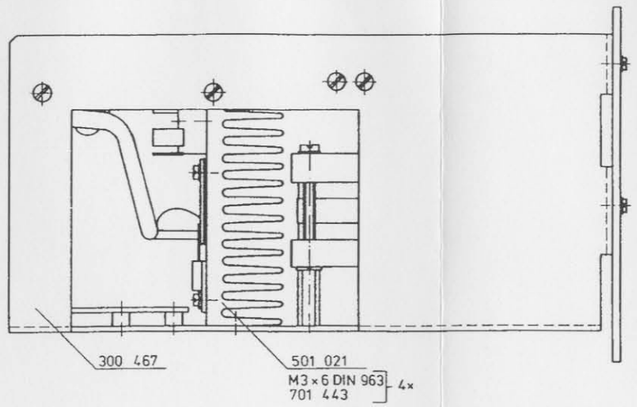

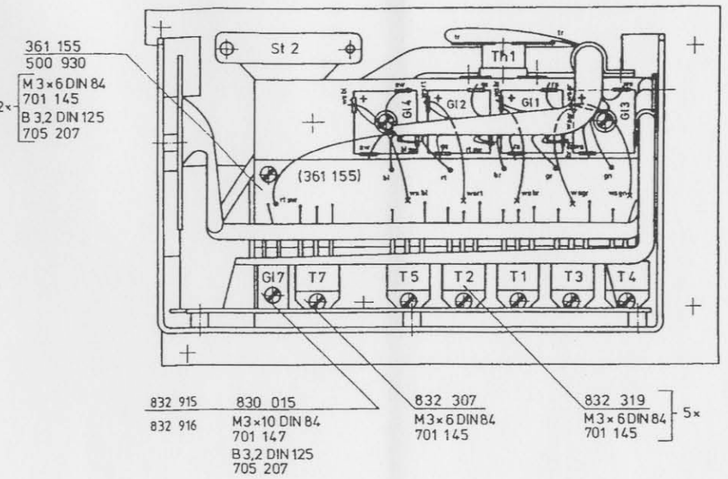

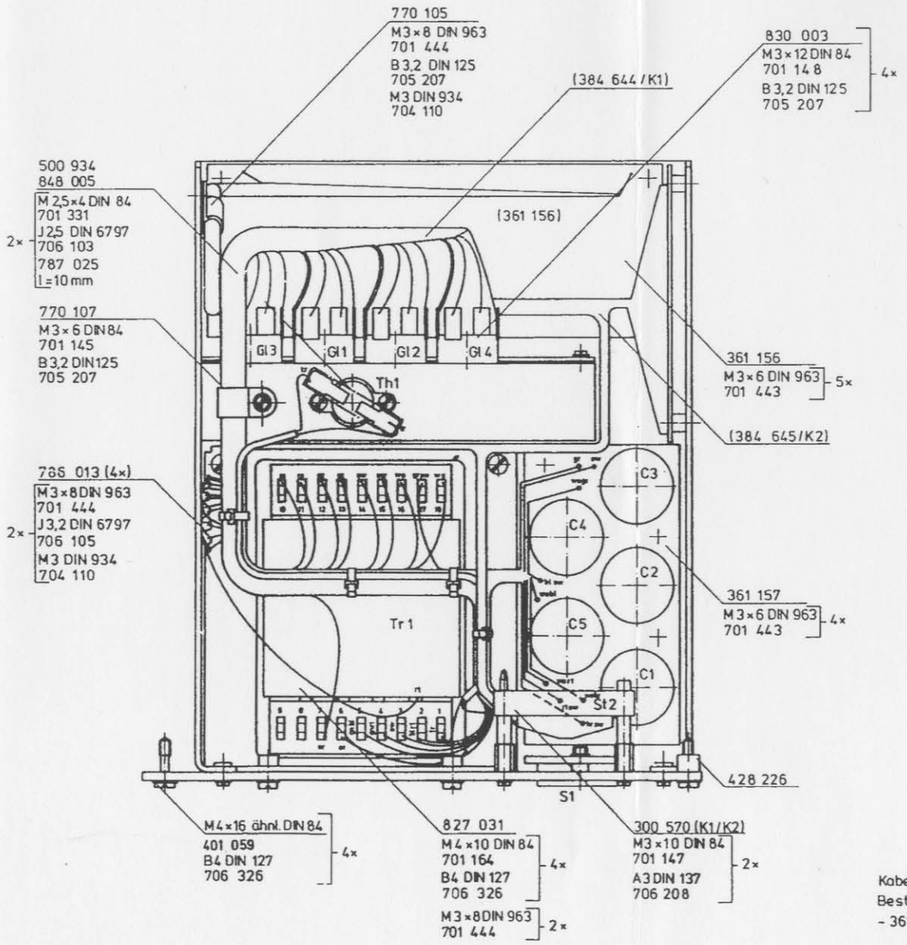

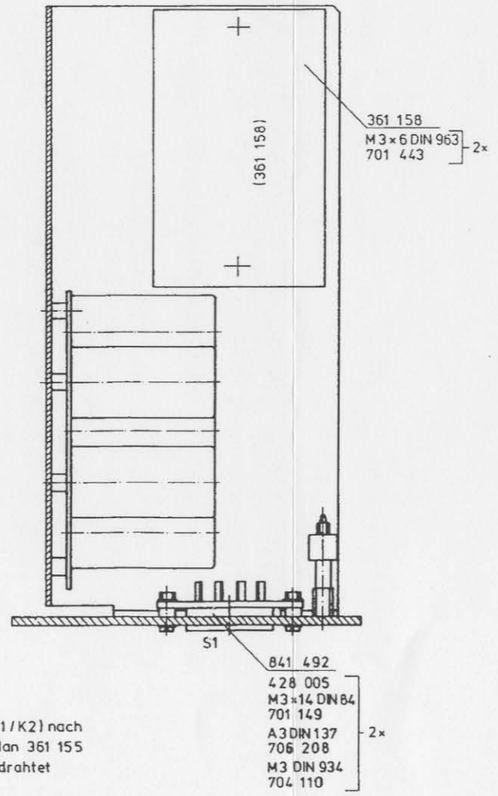

Kabelbaum (K1/K2) nach Bestückungsplan 361 155 - 361 158 verdrahtet

Verdrahtung Trafo - Spannungswähler

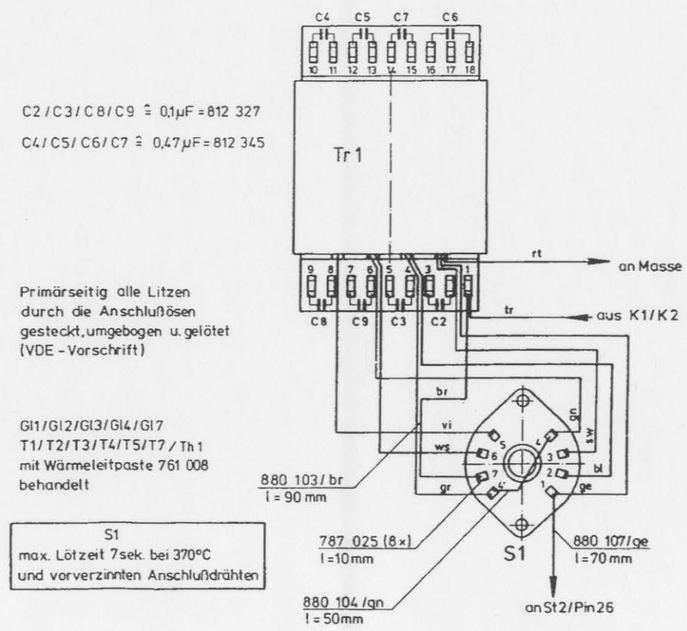

C2/C3/C8/C9 ≙ 0,1µF = 812 327

C4/C5/C6/C7 ≙ 0,47µF = 812 345

Primärseitig alle Litzen durch die Anschlußösen gesteckt, umgebogen u. gelötet (VDE - Vorschrift)

Gl1/Gl2/Gl3/Gl4/Gl7
T1/T2/T3/T4/T5/T7/Th1
mit Wärmeleitpaste 761 008 behandelt

S1
max. Lötzeit 7 sek. bei 370°C
und vorverzinnten Anschlußdrähten

= Kontrollmaß

Schlumberger o/s			
1:1	Netzteil		
	204 068		

Schaltplanpositionierung ≙ 204 068 S/Sa

verwendet in: 201 275

Gerät: 6902